

RENAL
C A R E

DORA[®]

Linha de Sangue para Hemodiálise
Registro na ANVISA (81971219001)
ISO 13485, Padrão realizado: ISO 8637-2





■ Linha de Sangue para Hemodiálise

■ **Compatível com a maioria das máquinas de diálise do mercado**

- FMC 2008/4008 series
- BBraun Dialog+ System
- Nikkiso DBB 03/05/06/07
- Gambro AK series
- Nipro

...

■ **Esterilização por óxido de etileno**

■ **Parede interna ultra lisa**

- dosagem estável de heparina
- reduz risco de coagulação



■ **Feito de PVC clinicamente aprovado e biocompatível, macio e anti-torção**


■ **Câmara de gotejamento projetada para atingir a precisão do fluxo sanguíneo e reduzir a espuma do sangue**

■ **Design de baixo volume disponível**

■ **Latex-free**

■ **DEHP-free**

**100% - composto
de PVC próprio**

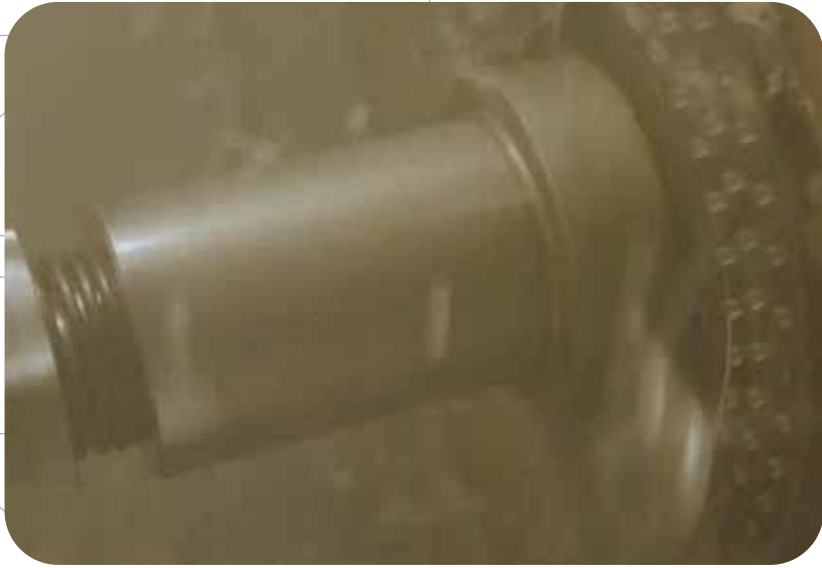

100% - Online Checking



DORA[®]

100% - Auto-injeção




100% - Testado contra vazamento



Conjunto de Tubos
DEHP / DEHP-FREE
LATEX-FREE
Esterilização por óxido de Etileno



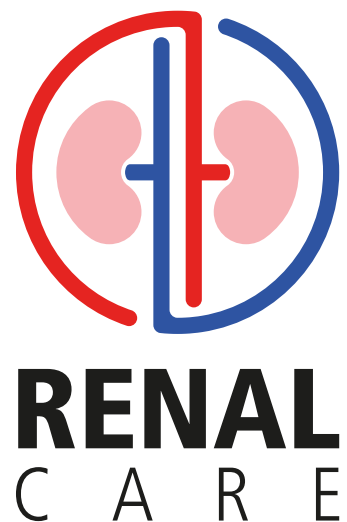

DORA[®]



Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd.

Endereço.: No. 10, Juncheng Road, Eastern Area,
Economic and Technological Development District,
Guangzhou, 510760 China

Tel: +86-20-82265249 - **Fax:** +86-20-32067500

E-mail: sales@baingz.com

Registrado, importado e distribuído a serviço da **Bain Medical Equipment (Guangzhou) Co., Ltd** por:

JM Vellame Comércio, Representação, Locação e Manutenção de Equipamentos Médicos Ltda

Endereço.: Av. Alcântara Machado, 611, sala 26, Brás. São Paulo – SP -
CEP: 03.101-005 | C.N.P.J.: 30.980.559/0001-96 - **Tel.:** (011) 2308-7607

Responsável Legal: Julio Melo Vellame CPF 947.482.765-68

Responsável Técnica: Elaine Giglioli CRF-SP: 38.036

Autorização ANVISA: 8.19.712-1 | **E-mail:** contato@vellame.com